

ピーク同定結果

試料： 221222-3 分析日時： 2022-12-22 12:17

アプリケーション： F-U_Solid_F_006 ファイル： 221222-3

スペクトル	No.	ピーク位置 (deg)	ネット強度 (kcps)	BG強度 (kcps)	線種
Si-KA	1	107.976	0.637	0.057	Si-SKA3
	2	109.047	9.383	0.042	Si-KA

蛍光X線分析



定性分析チャート

Rigaku

試料 221222-3

ファイル 221222-3

2022-12-22 12:17

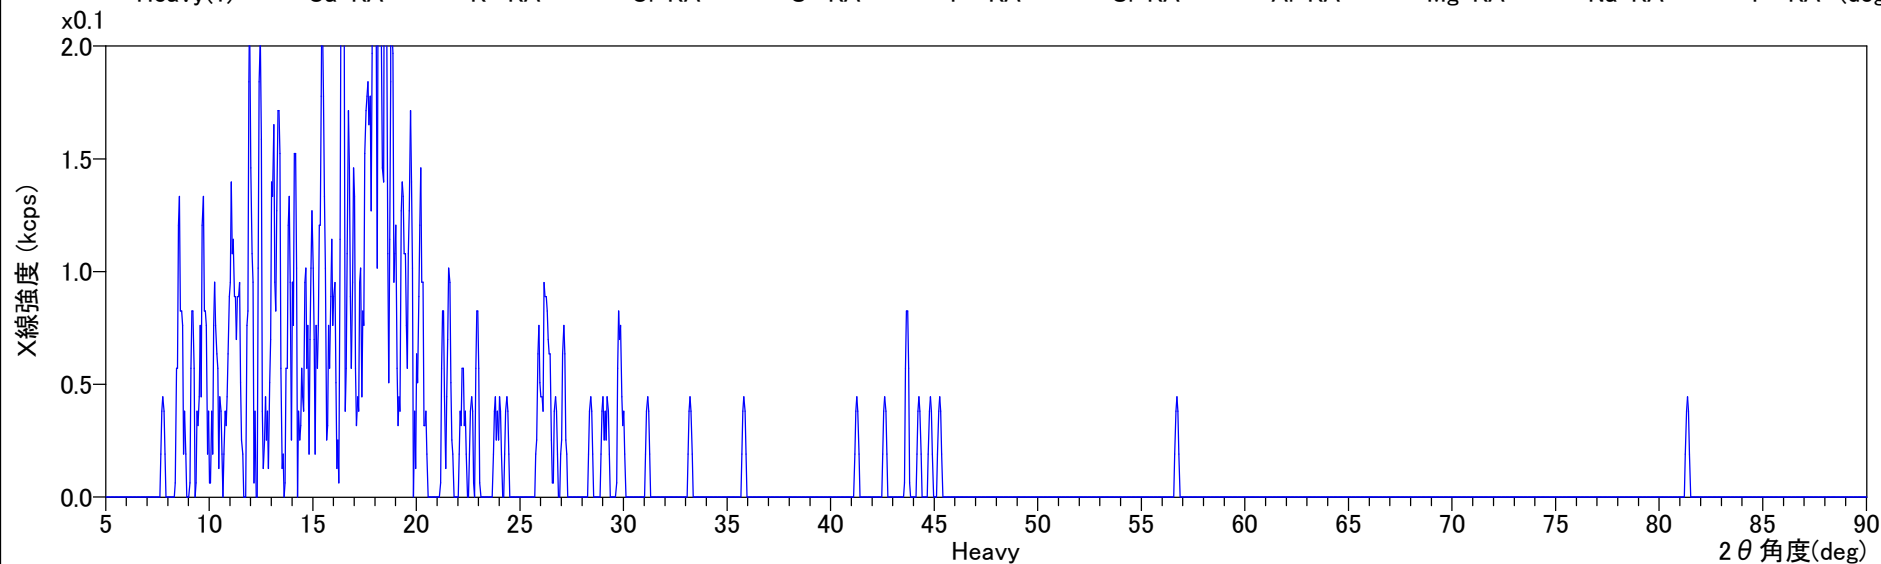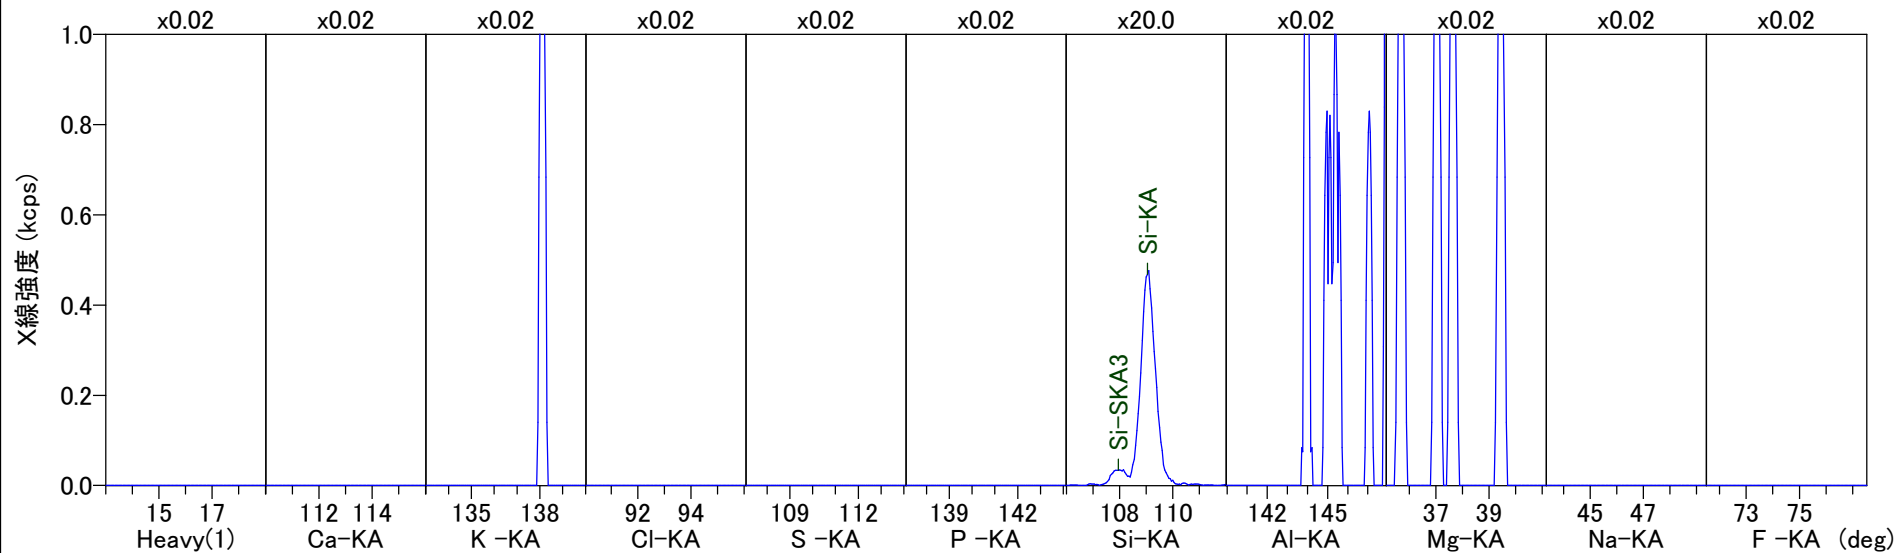

SQX分析結果

試料名 : 221222-3

アプリケーション : F-U_Solid_F_006

残分 :

マッチングライブラリ :

分析日時 : 2022-12-22 12:17

試料タイプ : 金属 & 合金

試料フィルム吸収補正 :

ファイル : 221222-3

不純物補正 :

No.	成分名	分析値	単位	検出下限	分析線	X線強度	規格化前
1	Si	100.0000	mass%	1.38001	Si-KA	9.3832	79.9383